

Θεσσαλονίκη: 5/10/2018

Αριθμ. Πρωτ:

ψτοχγράφη  
5-10-18

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια συσκευών παροχέτευσης θώρακος - Τεχνικές προδιαγραφές.


- Ο θάλαμος συλλογής θα πρέπει να έχει μέγιστη χωρητικότητα 2500 ml, ο οποίος να χωρίζεται σε 4 στήλες καταμέτρησης με τον πρώτο να ξεκινάει από 2cc μέχρι 200 cc για τον ακριβέστερο και πιο αποτελεσματικό έλεγχο της κατάστασης του ασθενούς.
- Το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα λειτουργίας με ελάχιστη ροή αέρα της τάξης των 16 L/ min.
- Να προσφέρει την δυνατότητα εφαρμογής αναρρόφησης χωρίς ύδωρ και χωρίς ηχητική λειτουργία, να είναι έτοιμο προς χρήση.
- Να υπάρχει έλεγχος της απόδοσης αναρρόφησης με ρυθμιστή που διατηρεί ένα συνεχές επίπεδο αναρρόφησης ανάμεσα στα -10cm και -40cm H<sub>2</sub>O. Επίσης να συνοδεύεται και με ηχητική επιβεβαίωση για κάθε αλλαγή.
- Να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου αναρρόφησης μέσω δείκτη που εμφανίζεται σε παράθυρο όταν επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο αναρρόφησης.
- Δυνατότητα διάγνωσης διαφυγής αέρα μέσω προαιρετικής πλήρωσης του μετρητή διαφυγής αέρα με νερό.
- Δυνατότητα λήψης δείγματος χωρίς βελόνα και προσθήκης ασκού αυτομετάγγισης μέσω ειδικών συνδετικών για τον ασκό αυτομετάγγισης με τα αυτο - σφραγιζόμενα port.
- Να αντισταθμίζει οποιαδήποτε μεγάλη διαρροή αέρα και διακύμανση στην αρνητική πίεση.

Η προμήθεια των συσκευών παροχέτευσης θώρακα ξηρής αναρρόφησης και υγρής στεγανοποίησης κρίνεται ως απαραίτητη για την κλινική μας και αναβαθμίζει ουσιαστικά την ποιότητα των υπηρεσιών μας γιατί συνδυάζει την ιδανική επίδοση παροχέτευσης και εξαιρετικής ασφάλειας για τον ασθενή αλλά και εξαιτίας της δυνατότητας που παρέχει για την πιο γρήγορη τοποθέτηση του προσφέρει πολύτιμο χρόνο σε όλο το προσωπικό της κλινικής.

Πιο συγκεκριμένα:

- Παρέχει μοναδική ασφάλεια στον ασθενή χάρη στην μονόδρομη βαλβίδα που εμποδίζει την παλινδρόμηση ακόμη και όταν η μονάδα έχει αναποδογυρίσει.

- Υπάρχει η δυνατότητα λήψης δείγματος ( χωρίς βελόνα) και προσθήκης ασκού αυτομετάγγισης μέσω των ειδικών συνδετικών για τον ασκό αυτομετάγγισης με τα αυτό-σφραγιζόμενα port.
- Η συσκευή αντισταθμίζει οποιαδήποτε μεγάλη διαρροή αέρα και διακύμανση στην αρνητική πίεση, πριν αυτή γίνει επικίνδυνη για την υγεία του ασθενούς.
- Η λειτουργία του μπορεί να γίνεται χωρίς νερό και χωρίς ηχητική λειτουργία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την γρηγορότερη τοποθέτηση στον ασθενή αλλά και την μεγαλύτερη ακρίβεια στα επίπεδα της αναρρόφησης.
- Διαθέτει εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης και μπορεί να διατηρεί ένα συνεχές επίπεδο αναρρόφησης ανάμεσα στα - 10 cm και - 40 cm H<sub>2</sub>O.

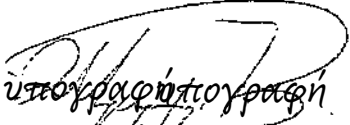  
 υπογραφή/υπογραφή  
~~υπογραφή/υπογραφή/υπογραφή/υπογραφή~~

υπογραφή  
 υπογραφή  
 υπογραφή  
 υπογραφή/υπογραφή/υπογραφή/υπογραφή


CB  
27/11/18  
Προμηθειών  
Προς: Γραφείο ~~Προμηθειών~~ Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

22612  
27/11/18

Θέμα: «Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών παροχτεύσεων θώρακα».

Η ποσότητα παροχτεύσεων θώρακα που θα χρειαστεί η Θωρακοχειρουργική Κλινική για την ετήσια κάλυψη νοσοκομειακών αναγκών ανέρχεται σε 1800 κομμάτια με τιμή κόστους 17,39 € το καθένα, συν 24% Φ.Π.Α. (Συνολικό κόστος 38.814,48 €).

Μπαρμπετάκης Νικόλαος

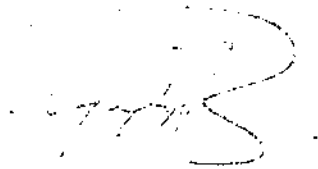

Κύργια Αναστασία



Πάντα Γλυκερία

